


磁気誘導ループ対応の補聴器をお持ちの方へ

以下の座席は磁気誘導ループに
対応しております。

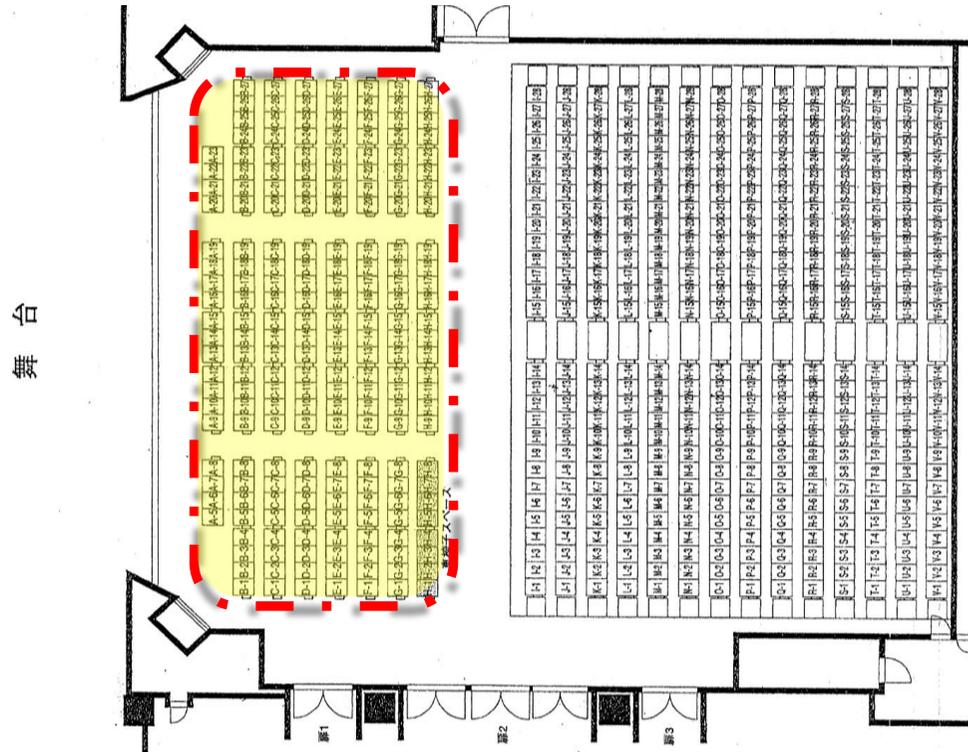

後方の階段席は対応しておりませんので、ご注意ください。

お持ちの補聴器のスイッチを「T」に切り替えてご対応ください。